



J. CROMATOGRAFÍA DE GASES-MASAS

Figura J.1 Cromatógrafo de gases con detector de espectro de masas



Figura J.2 Jeringa de inyección de muestra





Figura J.3 Columna capilar AT-35



Figura J.4 Espectro característico de la MDEA

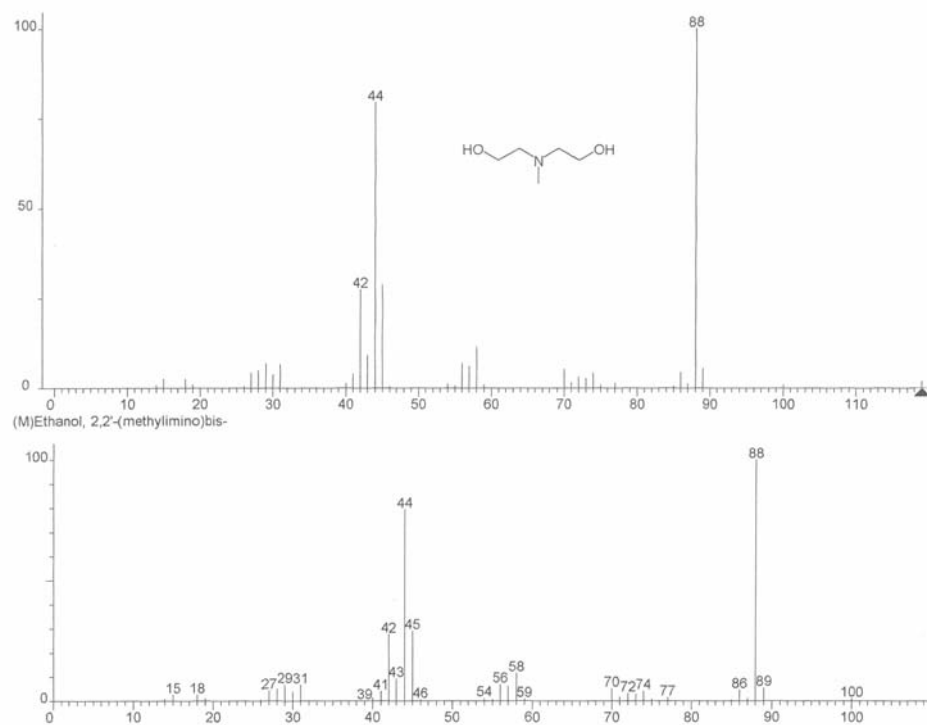




Figura J.5 Espectro característico de la DEA

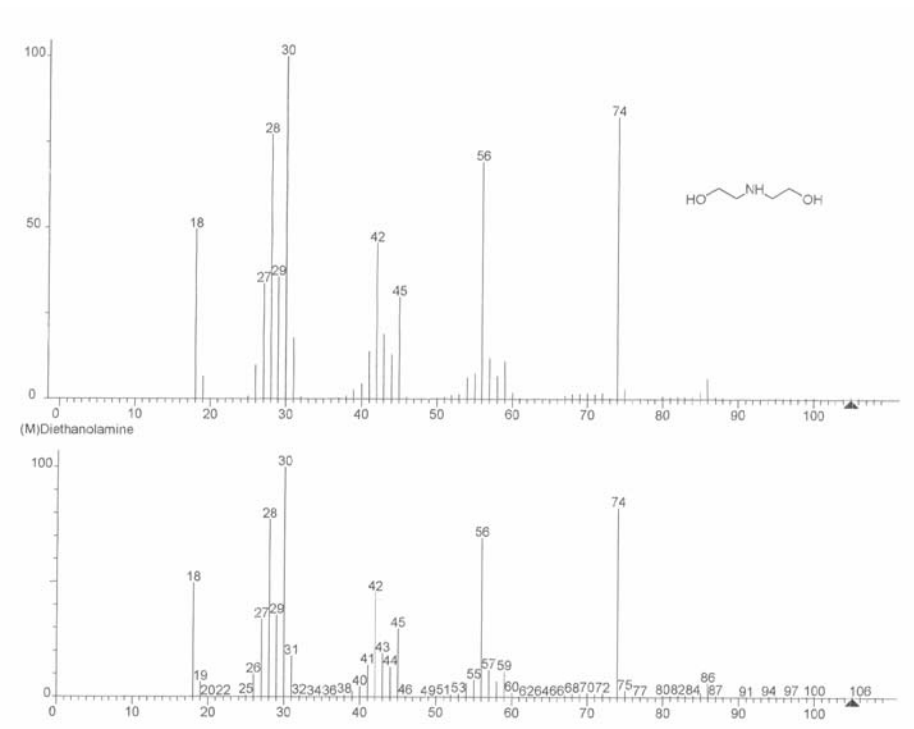


Figura J.6 Espectro característico del CO₂

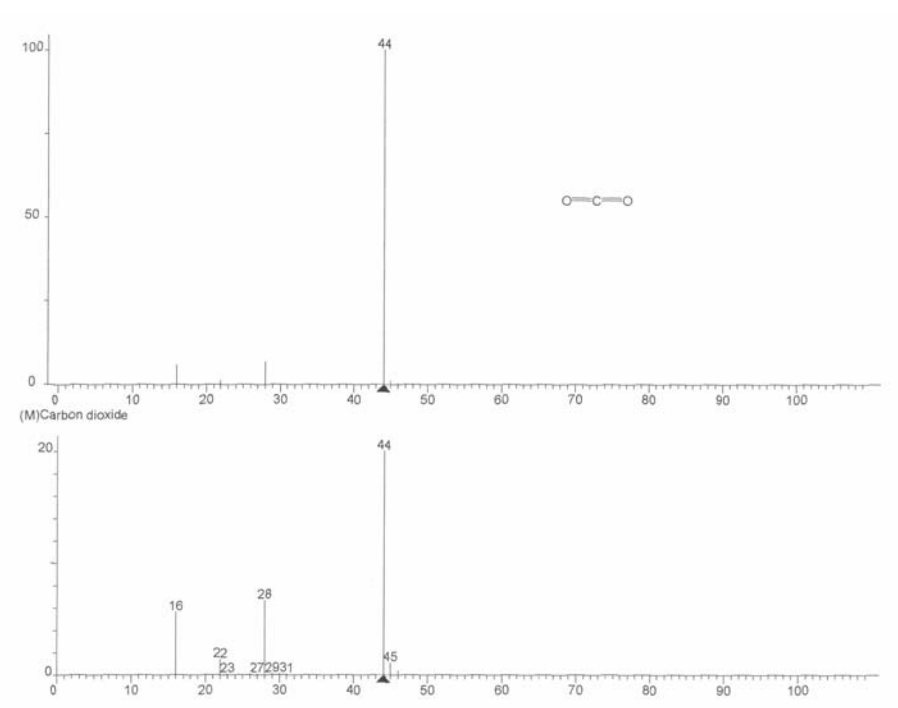




Figura J.7 Cromatograma de MDEA

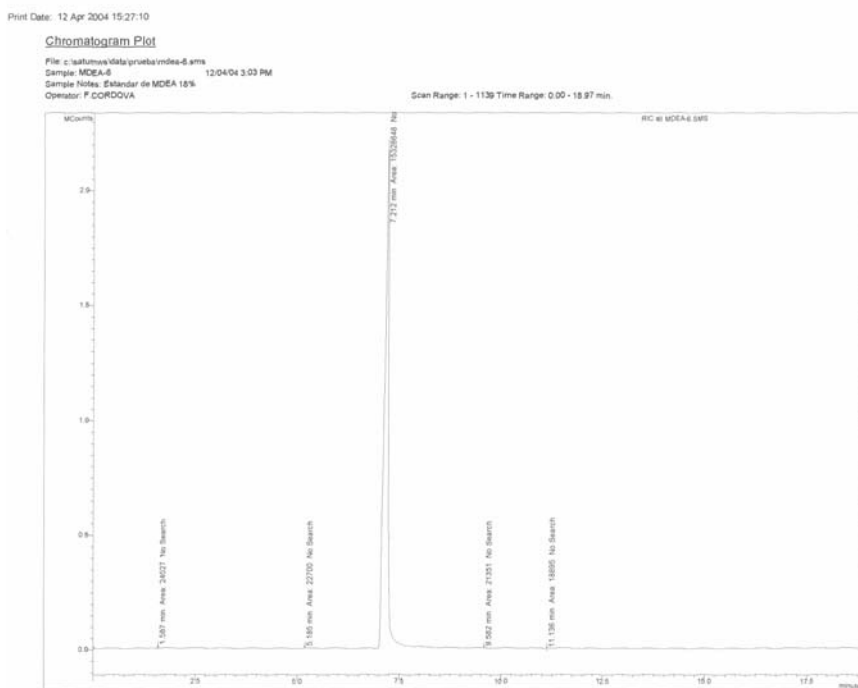


Figura J.8 Cromatograma de DEA

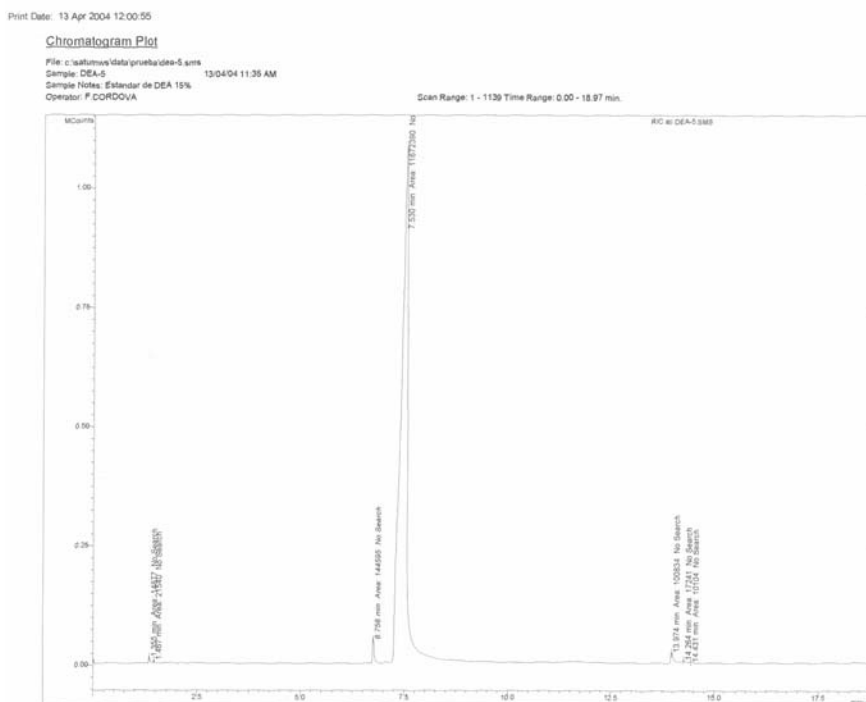




Figura J.9 Cromatograma de mezcla de aminos

Print Date: 01 Apr 2004 17:33:06

Chromatogram Plot

File: c:\saturnms\data\prueba\mezcla-2.sms
Sample: MEZCLA-2 1/04/04 3:02 PM
Sample Notes: ESTANDAR MEZCLA 2.75% AGUA
Operator: F.CORDOVA

Scan Range: 1 - 1139 Time Range: 0.00 - 18.97 min.

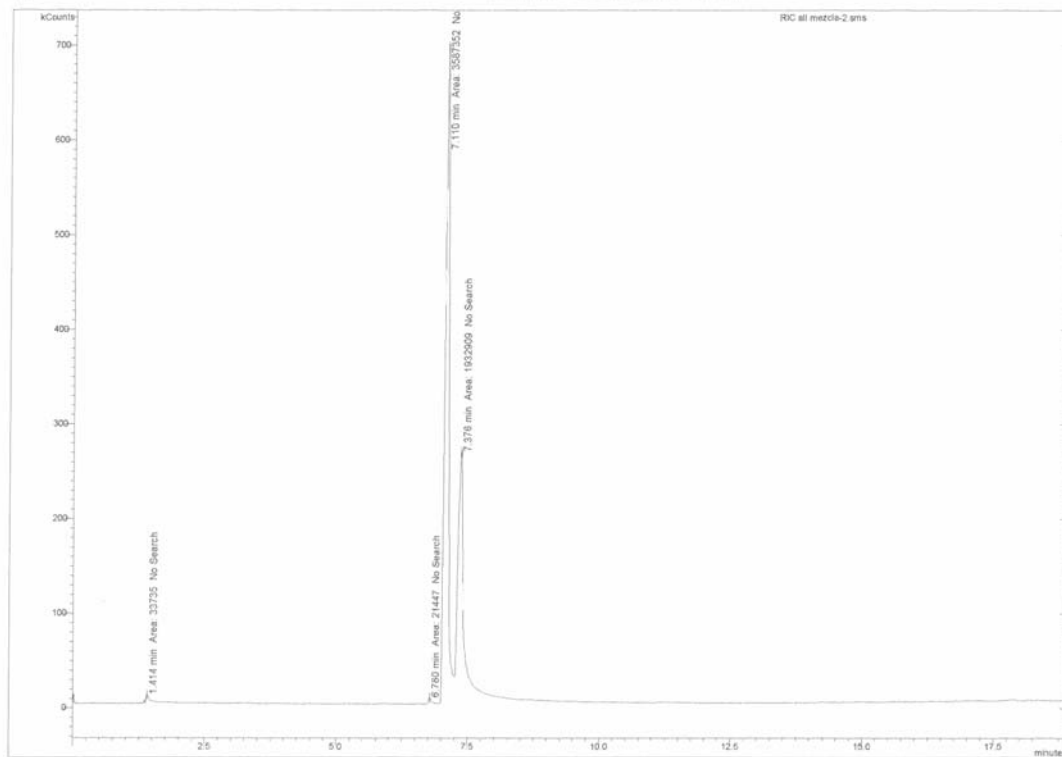




Figura J.10 Curva de Calibración de MDEA (CG/M)

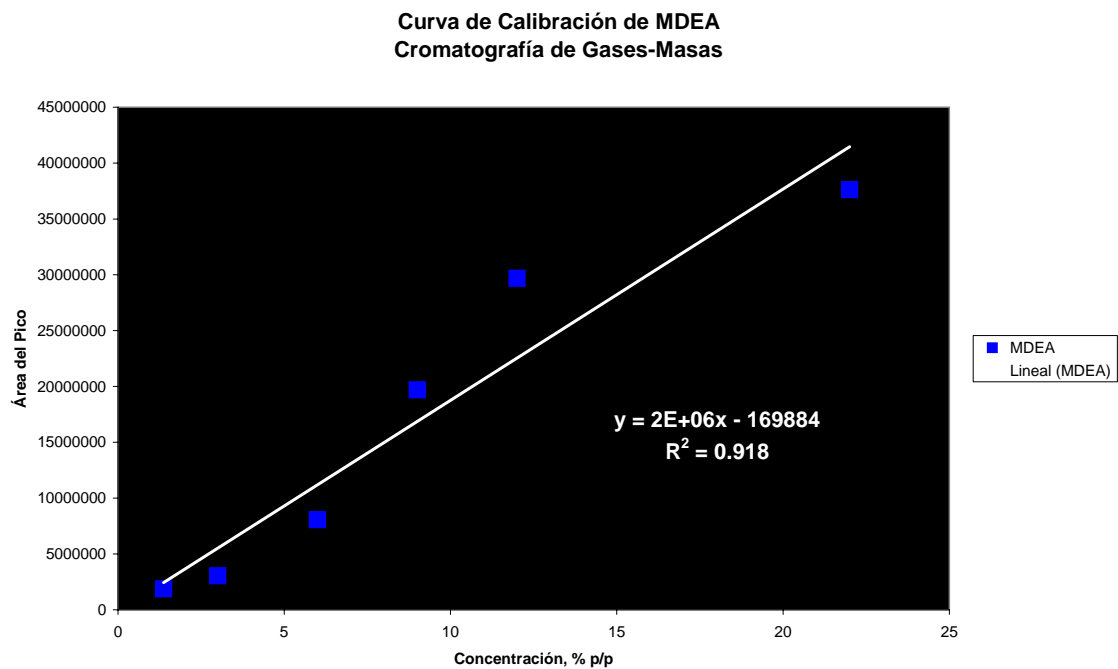


Figura J.11 Curva de Calibración de DEA (CG/M)

